



Messung



Kalibrierung

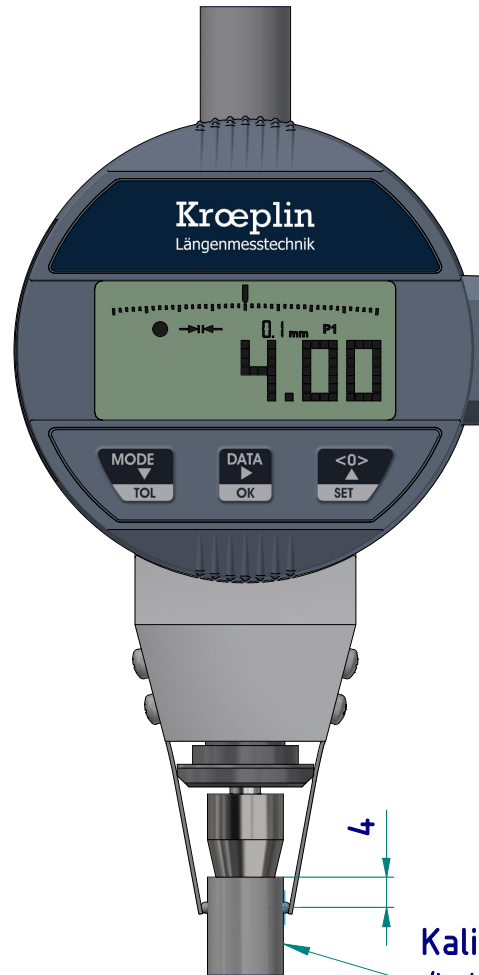

Lieferzustand

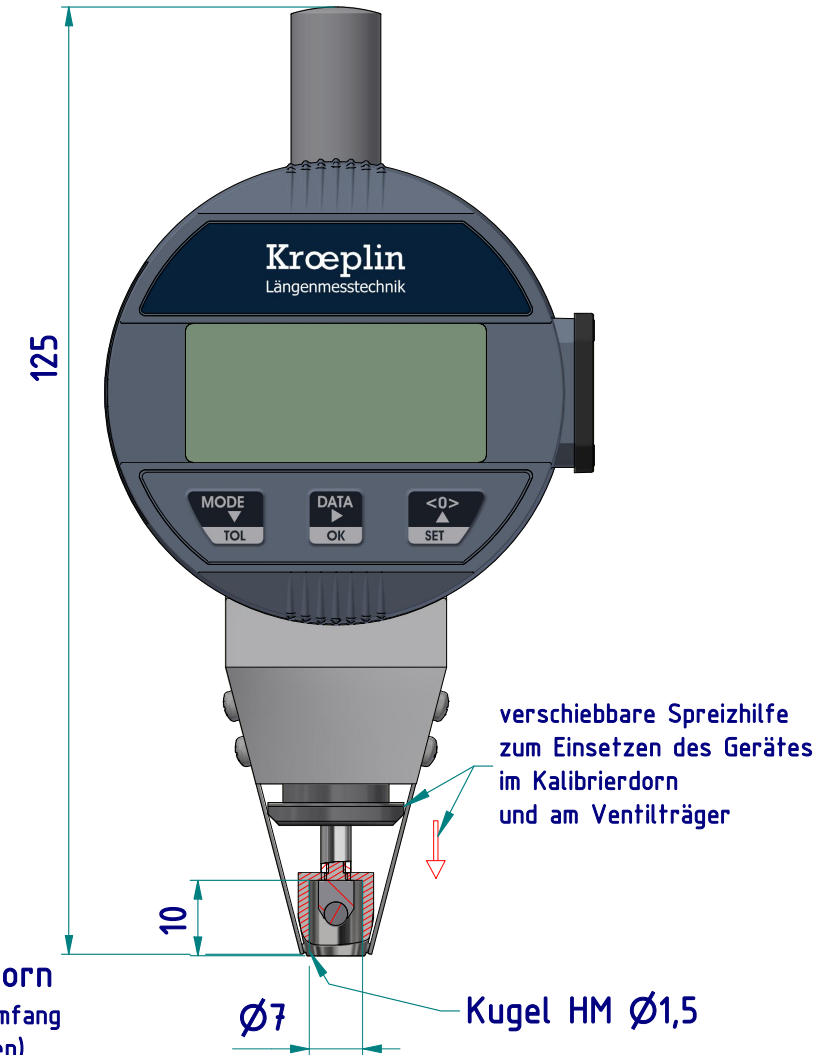

Serie: Aerosol
Messbereich: 2,5 - 8 mm
Anzeigebereich:
Zifferschrittwert: 0,01 mm
Skalenteilungswert:
Messkraft: 0,7 - 1,3 N
Gerätgewicht: ca 250 g

(Zulässige Abweichungen nach VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)
Fehlergrenze "G": 0,01 mm
Wiederholgrenze "r": 0,01 mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C - 30° C
Lagertemperatur: -10° C - 50° C

Maßstab: 1:1
Zeichnung-Nr.: IDW-AE1180-DB
Erstelldatum: 12.11.2010
Bearbeiter: Buchholz

Änderungsstand: 2310 (CT)
Änderungsdatum: 06.03.2024